



PRODUCT NAME: ICX

A-dec ICX tablets are specially formulated to maintain dental unit waterlines and prevent accumulation of odor and foul taste bacteria. Maintains dental unit waterline effluent ≤10 CFU/ml.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

WARNING

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

Causes moderate eye irritation, wear protective eyewear. Avoid contact with eyes, skin or clothing. Wash hands thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, or using tobacco.

DIRECTIONS FOR USE:

It is a violation of federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

ICX is intended for use in general dental applications by providing water to the dental syringe, various handpiece ancillary devices, and cuspidor cupfill. When used according to these instructions for every bottle refill, optimum efficacy for control of odor and foul taste bacteria can be achieved.

Before Refilling Bottle

1. Empty the bottle of all remaining water.
2. Drop tablet into an empty dental unit water bottle (0.7L tablet in 0.7 liter bottle, 2L tablet in 2 liter bottle). Avoid touching the tablet with unprotected skin.
3. Fill bottle with water and connect to the dental unit.
4. Wait 120 seconds for the tablet to fully dissolve.

NOTE: This product is intended for use with potable water and in conjunction with regular dental unit water testing, following flush (shock) treatment with an antimicrobial product registered with the U.S. EPA and recommended by the manufacturer.

STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food, or feed by storage or disposal. Store at room temperature out of direct sunlight; **DO NOT** store above 30°C (86°F). Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. Offer for recycling if available or dispose of empty outer foil pouch in the trash.

FIRST AID:

If solid product gets in eyes, hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15 to 20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first five minutes, then continue rinsing.

CONTACT INFORMATION

If you have a question that is not addressed in this document, please contact A-dec Customer Service at one of the following phone numbers:

- 1.800.547.1883 (within USA and Canada)
- +1.503.538.7478 (outside USA and Canada)

Customer service is available Monday through Friday from 5 a.m. to 5 p.m. Pacific Standard Time (PST).

Report all serious incidents involving A-dec products to A-dec, Inc. If the incident occurs in the EU, also report it to A-dec’s EU Authorized Representative and the competent authority of the EU Member State in which the user/patient is established.

产品名称：ICX

A-dec ICX 片剂经特殊配方，可保持牙科治疗台水管线路的清洁和预防异味细菌积聚。保持牙科治疗台水管线路中的污水不超过 10 CFU/ml。

勿让儿童接触。

警告

警示信息

对人体和家畜的危害

对眼睛中度刺激，请佩戴防护目镜。避免接触眼睛、皮肤或衣物。接触后和进食、喝水、嚼口香糖或吸烟前用肥皂和水彻底洗手。

使用说明：

若不按照标签说明使用本产品，则视为违反联邦法律。

ICX 用在将水输送到牙科灌注导管、各种手持辅助设备和痰盂给水的普通牙科应用中。在每次为瓶重新加注水而按照此处说明使用时，可获得控制气味和怪味细菌的最佳功效。

重新加注水瓶前步骤

1. 将瓶内所有剩余的水倒空。
2. 将净水片放入牙科治疗台的空水瓶中（0.7 升容量水瓶放 0.7 升的净水片，2 升容量水瓶放 2 升的净水片）。避免片剂接触裸露的皮肤。
3. 向瓶中加满水，并连接到治疗台。
4. 120 秒后片剂即可完全溶解。

注意：此产品用于在使用在美国国家环境保护局（U.S. EPA）注册并由制造商推荐的抗菌产品进行冲洗（休克）治疗后，与饮用水配合使用，并应同时对牙科治疗台用水进行定期测试。

储存和处置

在储存或丢弃时，切勿污染水、食物或饲料。在室温下储存，避免阳光直射；**不要**在 30°C (86°F) 以上的环境中储存。非重复充装容器。切勿重复使用或重新充装此容器。若有可能，请送交有关部门进行循环回收，或将空的金属箔外袋丢入垃圾桶中。

急救措施：

如果不慎让固体产品入眼，睁开眼睛，用清水慢慢且轻柔地冲洗 15 到 20 分钟。如果配戴隐形眼镜，则先冲洗五分钟再摘下隐形眼镜，然后继续冲洗。

联系信息

如果您有本手册中未说明的问题，请通过以下任一电话号码联系 A-dec 客户服务部门：

- 1.800.547.1883（美国及加拿大境内）
- +1.503.538.7478（美国及加拿大境外）

客户服务部门的服务时间为星期一到星期五，太平洋标准时间 (PST) 上午 5 点至下午 5 点。

向 A-dec, Inc 报告所有涉及 A-dec 产品的严重事件。如果该事件在欧盟发生，还应向 A-dec 的欧盟授权代表和用户/患者所在的欧盟成员国有关部门报告。

NOM DU PRODUIT : ICX

Les comprimés antibactériens A-dec ICX ont été spécialement élaborés pour préserver la propreté des conduites d’eau de l’unité dentaire et empêcher l’accumulation d’odeurs nauséabondes et de bactéries qui entraveraient le goût de l’eau. Maintient la qualité de l’eau dans l’unité à un niveau inférieur ou égal à 10 cfu/ml.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

AVERTISSEMENT

MISES EN GARDE

Risques pour les humains et les animaux domestiques

Peut causer une irritation modérée des yeux, porter des lunettes de protection. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Se laver soigneusement les mains avec du savon et de l’eau après toute utilisation et avant de manger, boire, mâcher du chewing-gum ou consommer du tabac.

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :

Toute utilisation de ce produit contraire aux indications figurant sur l’étiquetage constitue une violation de la loi fédérale des États-Unis.

ICX est destiné à être utilisé lors d’applications dentaires en amenant de l’eau dans la seringue dentaire, dans les divers dispositifs auxiliaires et dans le crachoir. Lorsque ce produit est utilisé conformément à ces instructions à chaque remplissage du réservoir, les odeurs putrides et les bactéries peuvent être contrôlées efficacement et de manière optimale.

Avant de remplir la bouteille.

1. Vider la bouteille de toute l’eau restante.
2. Mettre un comprimé dans la bouteille d’eau vide de l’unité (comprimé pour 0,7 L dans une bouteille de 0,7 L, comprimé pour 2 L dans une bouteille de 2 L). Se protéger la peau avant de toucher le comprimé.
3. Remplir la bouteille d’eau et la raccorder à l’unité dentaire.
4. Attendre 120 secondes pour que le comprimé soit complètement dissout.

REMARQUE : ce produit s'utilise avec de l'eau potable et doit être associé à des tests réguliers de l'eau des unités dentaires après traitement de rinçage (choc) à l'aide d'un produit antimicrobien homologué par l'EPA américaine et recommandé par le fabricant.

RANGEMENT ET ÉLIMINATION

Ne pas contaminer l’eau, les aliments pour humains ou pour animaux lors du stockage et de l’élimination. Conserver à température ambiante à l’écart de la lumière directe du soleil ; ne **PAS** conserver à une température supérieure à 30 °C (86 °F). Contenant non rechargeable. Ne pas réutiliser ni remplir à nouveau ce contenant. Recycler si possible, ou retirer la pochette extérieure en aluminium et jeter dans la poubelle.

PREMIERS SECOURS :

Si du produit solide entre dans l’œil, maintenir l’œil ouvert et rincer lentement et délicatement à l’eau pendant 15 à 20 minutes. Après cinq minutes, retirer les verres de contact, le cas échéant, puis continuer à rincer.

SERVICE CLIENTÈLE

Pour toute question non abordée dans ce document, contactez le service clientèle A-dec à l’un des numéros de téléphone suivants :

- 1.800.547.1883 (États-Unis et Canada)
- +1.503.538.7478 (hors des États-Unis et du Canada)

Le service clientèle est disponible du lundi au vendredi de 5 h à 17 h (heure du Pacifique).

Signalez tous les incidents graves impliquant des produits A-dec à A-dec, Inc. Si l'incident se produit dans l'Union européenne, signalez-le également au représentant agréé dans l'Union européenne A-dec et à l'autorité compétente de l'État membre de l'Union européenne dans lequel l'utilisateur/le patient est établi.

PRODUKTBEZEICHNUNG: ICX

A-dec ICX Tabletten wurden speziell dafür entwickelt, die Leitungen von Dentaleinheiten rein zu halten und der Entstehung von Geruch durch Geruchsbakterien vorzubeugen. Sie sorgen somit für einen ordnungsgemäßen Zustand der Leitungen der Dentaleinheit (≤ 10 KbE/ml).

FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN.

ACHTUNG

WARNHINWEISE

Potenzielle Gefahr für Menschen und Haustiere

Verursacht leichte Augenreizung, geeigneten Augenschutz tragen. Kontakt mit Augen, Haut oder Kleidung vermeiden. Nach dem Berühren der Tabletten und vor dem Essen, Trinken oder Rauchen Hände gründlich mit Wasser und Seife waschen.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Die Verwendung des Produkts auf eine andere Art und Weise als in den Anweisungen auf dem Etikett angegeben stellt einen Verstoß gegen das Bundesgesetz dar.

ICX ist für den Einsatz bei allgemeinen Dentalgeräten zur Wasserversorgung für Dentalspritzen, verschiedene Handstück-Zusatzgeräte und die Becherfüllung am Speibecken konzipiert. Bei ordnungsgemäßer Verwendung gemäß der vorliegenden Anweisungen für jede Flaschenfüllung wird eine optimale Wirksamkeit bei der Bekämpfung von Geruch und Geruchsbakterien erzielt.

Vor dem erneuten Füllen der Flasche

1. Restliches Wasser vollständig aus der Flasche entleeren.
2. Tablette in eine leere Dentaleinheit-Wasserflasche fallen lassen (0,7-Liter-Tablette in eine 0,7-Liter-Flasche, 2-Liter-Tablette in eine 2-Liter-Flasche). Dabei Tablette nach Möglichkeit nicht mit ungeschützten Händen berühren.
3. Flasche mit Wasser auffüllen und an die Dentaleinheit anschließen.
4. Ca. 120 Sekunden warten, bis sich die Tablette vollständig aufgelöst hat.

HINWEIS: Dieses Produkt ist zur Verwendung mit Trinkwasser und in Verbindung mit regelmäßigen Wassertests der Dentaleinheit vorgesehen. Zuvor muss eine Spülung mit einem antimikrobiellen, bei der U.S. EPA registrierten und vom Hersteller empfohlenen Produkt erfolgen.

AUFBEWAHRUNG UND ENTSORGUNG

Bei der Lagerung und Entsorgung darauf achten, dass Wasser, Lebensmittel oder Tiernahrung nicht verunreinigt werden. Bei Zimmertemperatur aufbewahren, keiner direkten Sonnenbestrahlung aussetzen; **NICHT** bei Temperaturen über 30°C lagern. Einwegverpackung. Diese Verpackung nicht wiederverwenden oder erneut befüllen. Leere äußere Folienverpackung nach Möglichkeit recyceln oder im Hausmüll entsorgen.

Erste-Hilfe-Anweisungen

Wenn das Produkt ins Auge geraten ist, das Auge geöffnet halten und für 15 bis 20 Minuten vorsichtig mit Wasser ausspülen. Bei Kontaktlinsenträgern erst nach 5 Minuten Spülen die Kontaktlinse herausnehmen und das Auge weiter ausspülen.

KONTAKTINFORMATIONEN


Wenn Sie eine Frage haben, die in diesem Dokument nicht angesprochen wird, wenden Sie sich bitte unter den folgenden Telefonnummern an den Kundendienst von A-dec:

- 1 800 547 1883 (innerhalb der USA/Kanadas)
- +1 503 538 7478 (außerhalb der USA/Kanadas)

Der Kundendienst steht Ihnen von Montag bis Freitag von 5–17 Uhr PST (Pacific Standard Time) zur Verfügung.

Alle schwerwiegenden Ereignisse im Zusammenhang mit Produkten von A-dec sind an A-dec, Inc. zu melden. Wenn das Ereignis in der EU auftritt, ist es auch dem autorisierten Vertreter von A-dec in der EU sowie den zuständigen Behörden des EU-Mitgliedsstaates, in dem der Benutzer/Patient ansässig ist, zu melden.

EPA Registration No. 79662-1
EPA Establishment No. 084100-CT-001

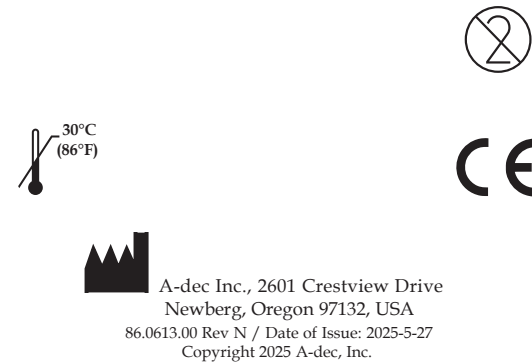

NAZWA PRODUKTU: ICX

Tabletki ICX firmy A-dec mają specjalne składniki, które konserwują linie wodne unitu stomatologicznego oraz zapobiegają powstawaniu nieprzyjemnego zapachu i rozwojowi bakterii pogarszających smak wody. Produkt utrzymuje ścieki z linii wodnej unitu stomatologicznego na poziomie ≤10 CFU/ml.

CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI

OSTRZEŻENIE

ZWROTY WSKAZUJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Zagrożenia dla ludzi i zwierząt domowych

Powoduje umiarkowane podrażnienie oczu. Używać okularów lub osłon ochronnych na oczy. Unikać kontaktu z oczami, skórą i ubraniem. W razie kontaktu ze środkiem starannie umyć ręce wodą z mydłem przed jedzeniem, piciem, żuciem gumy lub używaniem wyrobów tytoniowych.

SPOSÓB UŻYCIA:

Używanie tego produktu niezgodnie z oznaczeniem stanowi naruszenie prawa federalnego.

Środek ICX jest przeznaczony do ogólnych zastosowań dentystycznych w celu dostarczania wody do dmuchawki i różnych końcówek oraz napełniania kubka spluwaczki. Optymalną skuteczność kontroli nieprzyjemnego zapachu i rozwoju bakterii pogarszających smak wody można uzyskać, stosując się do niniejszej instrukcji podczas każdego napełniania butelki.

Przed napełnieniem butelki

- Opróżnić butelkę z całej pozostałej wody.
- Wrzucić tabletkę do pustej butelki na wodę unitu stomatologicznego (tabletkę 0,7 l do butelki 0,7 l lub tabletkę 2 l do butelki 2 l). Unikać kontaktu tabletki z odkrytą skórą.
- Napełnić butelkę wodą i podłączyć do unitu stomatologicznego.
- Zaczekać 120 sekund na pełne rozpuszczenie się tabletki.

UWAGA: Ten produkt jest przeznaczony do użytku z wodą pitną w połączeniu z regularnym badaniem wody unitu dentystycznego, po przepłukaniu biocydem zarejestrowanym przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA) i zalecanym przez producenta.

PRZECHOWYWANIE I USUWANIE

Przechowywać i usuwać, nie zanieczyszczając wody, żywności ani paszy dla zwierząt. Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym. **NIE** przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Pojemnik nie nadaje się do ponownego napełniania. Nie używać i nie napełniać pojemnika ponownie. Puste opakowanie foliowe należy w miarę możliwości poddać odpowiedniej utylizacji lub wyrzucić do śmietnika.

PIERWSZA POMOC:

Jeżeli do oka dostanie się produkt w stanie stałym, utrzymywać oko szeroko otwarte i powoli, delikatnie przemywać wodą przez 15–20 minut. Osoby poszkodowane noszące soczewki kontaktowe powinny je wyjąć po pierwszych 5 minutach przemywania, a następnie kontynuować przemywanie oka.

INFORMACJE KONTAKTOWE

Pytania, na które odpowiedzi nie zostały zamieszczone w niniejszym dokumencie, prosimy kierować do działu obsługi klienta firmy A-dec pod jednym z poniższych numerów telefonu:

- 1 800 547 1883 (w USA i Kanadzie)
- +1 503 538 7478 (spoza USA i Kanady)

Dział obsługi klienta jest dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 5:00–17:00 czasu pacyficznego PST (14:00–2:00 czasu środkowoeuropejskiego).

Wszystkie poważne incydenty z udziałem sprzętu firmy A-dec należy zgłaszać do firmy A-dec, Inc. Jeśli incydent ma miejsce w UE, należy również zgłosić go upoważnionemu przedstawicielowi firmy A-dec w UE oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego UE, w którym użytkownik/pacjent ma siedzibę.

NOME DEL PRODOTTO: ICX

Le compresse A-dec ICX sono formulate appositamente per la manutenzione delle linee idrauliche del riunito odontoiatrico e per prevenire l’accumulo di batteri responsabili di odori e sapori sgradevoli. Il prodotto consente di mantenere l’effluente delle linee idrauliche del riunito odontoiatrico a ≤10 CFU/ml.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI

AVVERTENZA

AVVERTENZE PRECAUZIONALI

Prodotto nocivo per gli esseri umani e per gli animali domestici

Causa moderata irritazione agli occhi, indossare dispositivi di protezione oculare. Evitare il contatto con gli occhi, con la cute e con gli indumenti. Dopo la manipolazione del prodotto, lavare accuratamente le mani con acqua e sapone prima di ingerire alimenti e bevande, masticare gomma o usare tabacco.

ISTRUZIONI PER L’USO:

L’utilizzo di questo prodotto in modo non conforme rispetto all’etichettatura rappresenta una violazione della legge federale.

ICX è destinato per l’uso in applicazioni odontoiatriche di carattere generale per fornire acqua alla siringa dentale, a vari manipoli ausiliari e al bicchiere del gruppo idrico. Se utilizzato secondo le istruzioni qui esposte ad ogni sostituzione dell’acqua del serbatoio, garantisce in modo ottimale un controllo efficace dei batteri responsabili di odori e sapori sgradevoli.

Prima di riempire il serbatoio

- Svuotare il serbatoio da tutta l’acqua rimanente.
- Inserire una compressa nel serbatoio d’acqua vuoto del riunito odontoiatrico (una compressa da 0,7 l per il serbatoio da 0,7 l, una compressa da 2 l per il serbatoio da 2 l). Evitare di toccare la compressa a mani nude.
- Riempire il serbatoio d’acqua e collegarlo al riunito odontoiatrico.
- Attendere 120 secondi fino al totale dissolvimento della compressa.

NOTA: questo prodotto è stato formulato appositamente per l’uso con acqua potabile e in congiunzione con una periodica analisi dell’acqua utilizzata per il riunito odontoiatrico, dopo irrigazione con un prodotto antimicrobico approvato dall’EPA statunitense e raccomandato dal produttore.

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

Durante la conservazione e lo smaltimento, non contaminare le acque o gli alimenti destinati ad animali o a esseri umani. Conservare a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta. **NON** conservare a temperature superiori a 30 °C (86 °F). Contenitore non ricaricabile. Non riutilizzare né ricaricare il contenitore. Riciclare in raccolta differenziata, se possibile, o smaltire come rifiuto la confezione esterna in alluminio.

PRONTO SOCCORSO:

In caso di contatto del prodotto solido con gli occhi, tenere gli occhi aperti e sciacquarli lentamente e delicatamente con acqua per 15-20 minuti. Se si indossano lenti a contatto, rimuoverle dopo 5 minuti e quindi continuare a sciacquare.

INFORMAZIONI DI CONTATTO

In caso di ulteriori domande alle quali non si è trovata risposta in questo documento, contattare il Servizio assistenza clienti di A-dec a uno dei seguenti numeri telefonici:

- 1.800.547.1883 (solo USA/Canada)
- +1.503.538.7478 (fuori da USA/Canada)

Il Servizio assistenza clienti è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 5.00 alle 17.00 (fuso orario del Pacifico).

Segnalare eventuali incidenti gravi che coinvolgono prodotti A-dec ad A-dec, Inc. Se l’incidente si verifica nell’UE, inviare una segnalazione anche al rappresentante autorizzato per l’UE di A-dec e all’autorità competente dello Stato membro dell’UE in cui si trova l’utente/il paziente.

NOMBRE DEL PRODUCTO: ICX

Las tabletas A-dec ICX están especialmente formuladas para el mantenimiento de los conductos de agua de la unidad dental y evitar la acumulación de olor y bacterias que ocasionan un sabor desagradable. Mantenga el afluente del conducto de agua de la unidad dental en ≤10 CFU/ml.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

ADVERTENCIA

ADVERTENCIAS DE PRECAUCIÓN

Riesgos para los seres humanos y animales domésticos:

Causa irritación ocular moderada, use gafas de protección. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Lávese bien las manos con agua y jabón después de tocarlas y antes de comer, beber, masticar goma de mascar o consumir tabaco.

INSTRUCCIONES DE USO:

Es una violación de la ley federal usar este producto de una manera incompatible con su etiquetado.

ICX está pensado para ser utilizado en las aplicaciones dentales generales al proporcionar agua a la jeringa dental, a varios dispositivos auxiliares de pieza de mano y al llena vaso de la escupidera. Cuando se siguen estas instrucciones de uso cada vez que se vuelve a llenar la botella, se logra obtener una eficacia óptima en el control de olor y bacterias que ocasionan un sabor desagradable.

Antes de volver a llenar la botella

- Vacíe completamente la botella de agua.
- Coloque la tableta en una botella de agua de la unidad dental vacía (una tableta para 0,7 l en una botella de 0,7 l, una tableta para 2 l en una botella de 2 l). Evite tocar la tableta sin protegerse la piel.
- Llene la botella de agua y conéctela a la unidad dental.
- Espere 120 segundos hasta que la tableta se disuelva por completo.

NOTA: Este producto debe utilizarse con agua potable y junto con la supervisión regular del agua de la unidad dental, y debe seguir un tratamiento (choque) de purga con un producto antimicrobiano que esté registrado en la Agencia de protección ambiental de EE. UU. y recomendado por el fabricante.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

No contamine el agua, los alimentos para humanos o animales con sus prácticas de almacenamiento o de desecho. Almacene el producto a temperatura ambiente, alejado de la luz directa del sol, **NO** lo conserve a temperatura superior a 30°C (86°F). Recipiente no recargable. No reutilice ni recarge este recipiente. Si es posible, recíclelo o deséchelo con un envoltorio de papel de plata.

PRIMEROS AUXILIOS:

Si el producto sólido entra en contacto con los ojos, manténgalos abiertos y aclárelos lenta y suavemente con agua durante un periodo de entre 15 y 20 minutos. En caso de llevar lentes de contacto, aclare los ojos durante 5 minutos antes de quitárselas y siga aclarándolo.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Si tiene alguna pregunta que no se haya cubierto en este documento, comuníquese con Servicio al Cliente de A-dec a través de uno de los siguientes números de teléfono:

- 1.800.547.1883 (dentro de Estados Unidos y Canadá)
- +1.503.538.7478 (fuera de Estados Unidos y Canadá)

El Servicio al Cliente está disponible de lunes a viernes de 5 a. m. a 5 p. m., hora estándar del Pacífico (PST).

Informe a A-dec, Inc. todos los incidentes graves que involucren productos A-dec. Si el incidente ocurre en la UE, informe también al representante autorizado de la UE de A-dec y a la autoridad competente del Estado miembro de la UE en el que se encuentra establecido el usuario o el paciente.

PRODUCTNAAM: ICX

ICX-tabletten van A-dec zijn specifiek geformuleerd voor het onderhoud van waterleidingen van tandheelkundige units en voorkomen de opeenhoping van geuren en vieze smaak veroorzakende bacteriën. Houdt het afvoerwater van de waterleiding van de behandelunit op ≤10 kve/ml.

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN

WAARSCHUWING

VERKLARINGEN BETREFFENDE VOORZORGSMAATREGELEN

Risico's voor mensen en huisdieren

Veroorzaakt milde irritatie aan de ogen; draag een oogbeschermende bril. Vermijd contact met ogen, huid en kleding. Was uw handen grondig met water en zeep na het omgaan met de tabletjes en vóór eten, drinken, gebruik van kauwgom of gebruik van tabaksartikelen.

AANWIJZIGINGEN VOOR GEBRUIK:

Het gebruik van dit product op een manier die niet overeenkomt met het etiket is een schending van de federale wetgeving.

ICX is bedoeld voor gebruik in algemene tandheelkundige toepassingen en levert water aan de tandheelkundige spuit, verschillende hulpstukken van het handstuk en voor het vullen van de beker van de spittoon. Bij gebruik in overeenstemming met deze aanwijzingen voor elke nieuwe vulling van de waterfles kan de optimale werkzaamheid voor de beheersing van geuren en vieze smaak veroorzakende bacteriën worden bereikt.

Voordat u de fles opnieuw vult

- Laat eventueel resterend water uit de fles lopen.
- Laat een tabletje in de lege waterfles van de tandheelkundige unit vallen (tablet voor 0,7 liter in waterfles van 0,7 liter, tablet voor 2 liter water in waterfles van 2 liter). Voorkom dat het tabletje in contact komt met de onbeschermde huid.
- Vul de fles met water en sluit deze aan op de tandheelkundige unit.
- Wacht 120 seconden zodat het tabletje geheel kan oplossen.

OPMERKING: Dit product is bestemd voor gebruik met drinkwater en in combinatie met regelmatige watertests van de tandartsunit, na een spoelbehandeling (shock) met een antimicrobisch product dat bij de Amerikaanse EPA is geregistreerd en door de fabrikant wordt aanbevolen.

OPSLAG EN AFVALVERWERKING

Vermijd verontreiniging van water, voedsel of voeding voor (huis) dieren als gevolg van opslag of afvalverwerking. Zorg voor opslag op kamertemperatuur, vermijd opslag in direct zonlicht; **NIET OPSLAAN** boven 30 °C. Niet-navulbare container. Deze container niet opnieuw gebruiken of opnieuw vullen. Bied deze aan voor recycling, indien beschikbaar, of gooi de lege buitenste verpakking van folie in de prullenbak.

EERSTE HULP:

Als het vaste product in de ogen komt, houd u het oog open en spoelt u dit gedurende 15 tot 20 minuten langzaam en grondig met water. Verwijder eventueel aanwezige contactlenzen pas na vijf minuten en ga daarna door met spoelen.

CONTACTINFORMATIE

Als u een vraag hebt die niet is behandeld in dit document, neem dan contact op met de klantenservice van A-dec: 1.800.547.1883 (binnen de VS en Canada) 1.503.538.7478 (buiten de VS en Canada)

De klantenservice is beschikbaar van maandag t/m vrijdag vanaf 5.00 uur tot 17.00 uur Pacific Standard Time (PST).

Meld alle ernstige incidenten met betrekking tot A-dec-producten aan A-dec, Inc. Als het incident plaatsvindt in de EU, meld het dan ook aan de erkende vertegenwoordiger van A-dec en aan de bevoegde autoriteit van de EU-lidstaat waar de gebruiker/patiënt is gevestigd.